

取扱説明書



電動診察台β TB-1346

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。ここに示した事項は安全にお使いいただくことにより、事故を未然に防止するためのものです。

区分	危険や損害の大きさと切迫の度合い
警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

警告	電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。差し込みが不完全だとショートや発熱により発火の原因となります。
	使用しないときは電源プラグを抜いてください。不用意な操作で思わぬ事故が起きたり、絶縁劣化による漏電火災の原因となります。
	電源コードやプラグは傷んだ状態で使用しないでください。感電や発火の原因となります。
	電源プラグを抜くときはコードを持たずに、電源プラグを持って引き抜いてください。電源コードが破損し感電や発火の原因となります。
	ベッドを設置する際には、必ず平らでしっかりした床の上に設置してください。傾いた場所に設置しますとベッドが転倒する恐れがあります。
	ベッドの作動前、及び作動中は、まわりの人の身体や手足、障害物が無いか十分注意してください。ベッドに挟まれ、人身事故や物損事故の原因になります。
	本製品は電気機器を使用していますので、水をかけたりしないでください。故障や感電の恐れがあります。
ベッドを移動させるときは、高さを最下限まで下げてから移動させてください。転倒して人身事故や物損事故等の原因になります。	

注意	150kg以上の荷重をかけないでください。転倒事故や作動不良となります。
	電源コードの上に物を置かないでください。コードがきずついて、断線、ショートによる感電や発火の原因になります。
	使用前に各部が正常かつ安全に作動することをご確認ください。
	ゆらみ、がたつき、傾き、音等に常に注意して、点検を行ってください。また少しでも違和感を感じたときはご使用を中止してください。
	コードで脚を引っかけないようにご注意ください。
	昇降を連続して使用するとモーターが加熱してきます。2分以上連続で作動させないでください。
	手元スイッチは押し間違いの無いように、十分注意して操作を行ってください。操作を行う人は回りに十分注意を払い、言葉を掛けてからベッドの動作を行ってください。
	ぐらつきが発生する場合は、アジャスターで微調整してからご使用ください。故障や破損の恐れがあります。
	ご使用中に異常な揺れが発生したら、使用を中止し、各部の締め付けボルトの再点検を行ってください。又、改善されない場合は、ご購入代理店にご相談ください。
アジャスターゴム、脚部キャップ及びキャスターの樹脂等によって、床材と床の表面処理材（ワックス等）が化学反応を起こし、変色する恐れがあります。設置場所等には十分ご注意ください。よろしくお願いいたします。	



モーターの仕様

●中国製モーター

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力 (6000N 負荷時)	MAX: 約 120W/1A
昇降速度 (100kg 荷重時)	上昇: 約 29 秒 / 下降: 約 25 秒
最大耐荷重	150kg
電源コードの長さ	4m

組立方法


座シートを裏返した状態で、下図のように脚部を取り付けてください。
※ボルト締め付け後、ボルトキャップを取り付けてください。

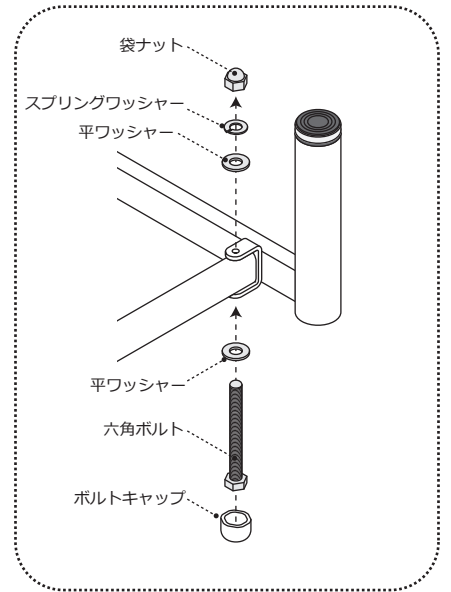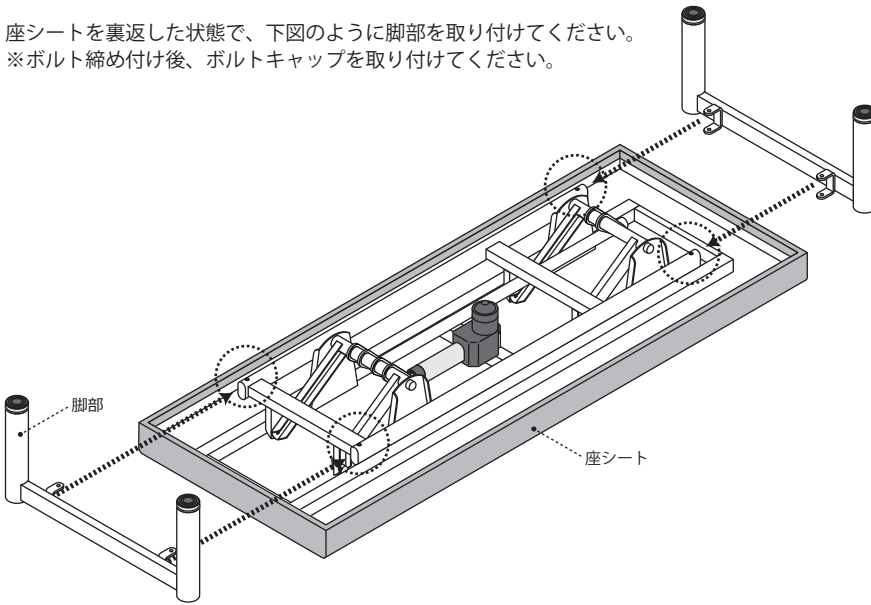

各部の名称及び使用方法

●ご使用前に必ずお読みください。

△ベッドは垂直に昇降しません。前後に円弧を描きながら昇降しますので、壁、または人から離して設置してください。

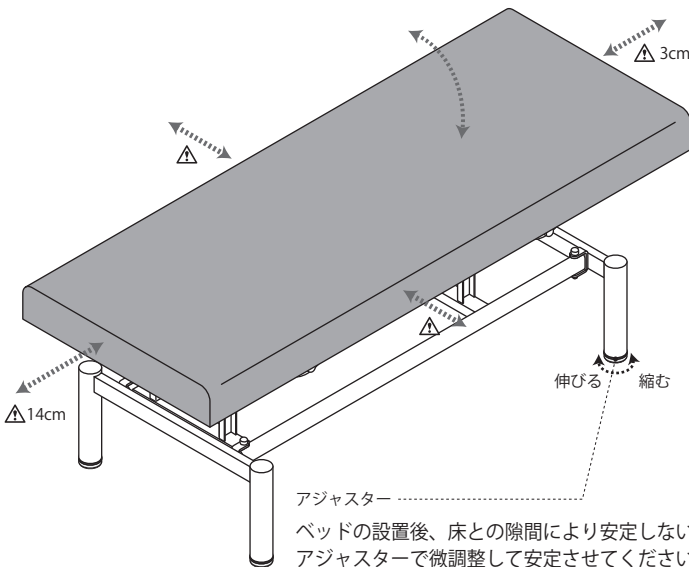

電動式高さ調節機能
手元スイッチ操作で、高さ調節することができます。

↑ 押している間シートが上昇します。離すと停止します。

↓ 押している間シートが下降します。離すと停止します。

※手元スイッチを押して昇降ができない場合、手元スイッチ裏側の電池カバーを外して、単四乾電池 (3 本) の交換をしてください。




本製品には、電池が内蔵されていますが、ご購入時期やご使用の頻度、環境により、予期せぬ速さで寿命がきれることがあります。また、自然放電によってまれに電池寿命が切れている場合がありますのでご了承ください。

アジャスター
ベッドの設置後、床との隙間により安定しない場合は、アジャスターで微調整して安定させてください。

手元スイッチのリセット方法

△手元スイッチの増設や交換の際には、下記方法でフットスイッチをリセットしてください。

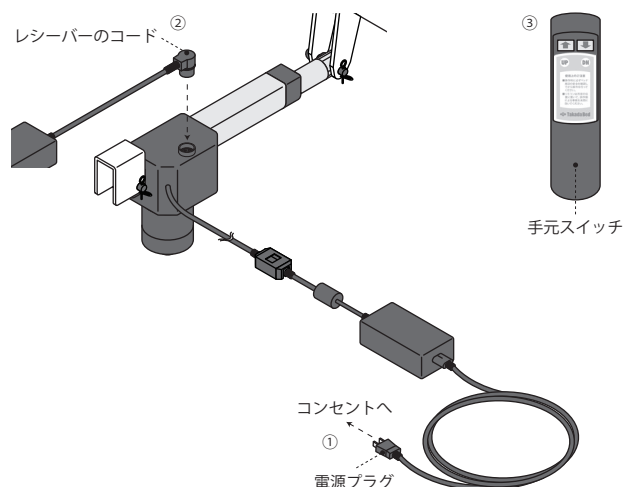

- ① 電源プラグをコンセントに差ししてください。
- ② レシーバーのコードを一度外し、再度差し込んでください。
- ③ “ピー” と音が鳴っている間に、手元スイッチの上昇側・下降側を同時に押してください。

修理を依頼する前に

●「故障かな？」と考える前に次の点をお調べください。

症状	ここをお調べください	処 置
ベッドが動かない	電源が入らない 電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	確実に差し込んでください。
	電源が入らない 電源コードが断線していませんか？	電源コードの交換が必要です。
電源が入っている	手元スイッチを押しても反応していませんか？	手元スイッチの交換が必要です。
	連続して昇降操作をしていませんか？	約 10 分後に操作を再開してください。
がたつき・傾きがある	アジャスターの調節がされていますか？	アジャスターを回転させて微調整してください。